

PACKAGE CONTENTS

THE AMNIOCHECK CONTAINS:
- 5 test panty liners, and instruction for use (ref. 100088-5)
or
- 30 test panty liners, and instruction for use (Ref. 100088-30)



Keep the AMNIOCHECK sealed and use it immediately after opening.

CONDITIONS FOR USE

To ensure valid results, do not use the AMNIOCHECK device if the answer to any of the following questions is YES:

- 1) Is it less than 12 hours after sexual intercourse?
- 2) Is it less than 12 hours after vaginal douching?


During bleeding results reading may need professional assistance. Report all bleeding situations to your physician.

Disregard positive result and retest if there is a possibility of wetness/ wetness remains from shower, bath etc, as these may interfere with the results.

In case of sensitization or irritation of skin, at the application site, stop use and contact your physician

DIRECTIONS FOR USE

1) Tap water can interfere with the test – wash and dry your hands.

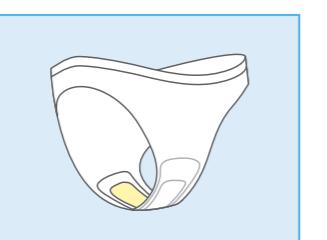

2) Unwrap the AMNIOCHECK panty liner. The panty liner contains a pale yellow indicator.

3) Attach the panty liner to your underwear. The pale yellow indicator strip should sit directly against your vagina. Wear the panty liner as you would a normal panty liner until you feel wetness (do not exceed 12 hours).

Note: use the panty liner while sitting, standing or walking. Do not use the panty liner while lying down.

4) When you feel a fluid leak, remove the panty liner and wait 15 minutes. Then check for a color change on the panty liner's yellow background. Also when replacing with a new panty liner, check for a color change.

5) If you feel wetness and the panty liner is completely yellow, after 15 minutes, consider using another test.

6) Dispose the panty liner as you would have disposed other hygiene products.

RESULTS INTERPRETATION

15 MINUTES AFTER REMOVAL LOOK FOR A COLOR CHANGE ON THE PANTY LINER.

Result reading should be done in a well illuminated place.



PROBABLE AMNIOTIC FLUID LEAK

If there is a color change, partial or complete, to blue or green (any intensity), in any size, shape or location, on the panty liner, the fluid leak is probably amniotic fluid. The color change can look cloudy and can be more intense along part of the yellow strip edge. In any such case, consult your physician or go to the hospital without delay.

Important: The indicator strip may also turn blue or green if vaginal infection is detected. If the indicator strip turns blue or green, always consult your physician.



POSITIVE RESULTS
Color stain options



NEGATIVE RESULTS
Color stain options

PROBABLE NEGATIVE RESULT

If the panty liner did not change color (remained yellow or turned yellow after 15 minutes), the vaginal wetness was probably not caused by amniotic fluid. If you continue to experience vaginal wetness, apply a new panty liner and repeat the test and consult your physician.

Warning: In case of heavy leaks or the suspect of broken waters, please seek medical advice immediately, even if the device does not change color.

PERFORMANCE DATA

A total of 232 pregnant women were enrolled in a pivotal study of the AMNIOCHECK Test Kit. The AMNIOCHECK, as a continuity test, demonstrated a sensitivity of 97.06% (99/102), with a 95% CI of [91.64%;99.39%] and specificity of 96.92% (126/130), with a 95% CI of [92.31%;99.16%].

- 1) Bornstein J, Geva A, Salt I, Fait V, Schoenfeld A, Shoham HK, Sobel J. Nonintrusive diagnosis of premature ruptured amniotic membranes using a novel polymer. Am J Perinatol. 2006 Aug; 23(6):351-4.
- 2) Bornstein J, Ohel G, Sorokin Y, Reape KZ, Shnaider O, Kessary-Shoham H, Ophir E. Effectiveness of a novel home-based testing device for the detection of rupture of membranes. Am J Perinatol. 2009 Jan;26(1):45-50.

VERPACKUNGSHINHALT

DAS AMNIOCHECK ENTHÄLT:

- 5 Test-Slips inlays and one Gebrauchsanweisung (ref. 100088-5)
or
- 30 Test-Slips inlays and one Gebrauchsanweisung (Ref. 100088-30)



Halten Sie die AMNIOCHECK versiegelt und verwenden Sie sie sofort nach dem Öffnen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Um gültige Ergebnisse zu gewährleisten, verwenden Sie das AMNIOCHECK-Gerät nicht, wenn die Antwort auf eine der folgenden Fragen JA ist:

- 1) Ist es weniger als 12 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr?
- 2) Ist es weniger als 12 Stunden nach einer Vaginaldusche?


Bei Blutungen benötigen Sie beim Ablesen möglicherweise professionelle Hilfe. Berichten Sie alle Blutungssituationen Ihrem Arzt.

Vernachlässigen Sie ein positives Ergebnis und wiederholen Sie es, wenn es eine Möglichkeit von Nässe / Restnässe von Dusche, Bad usw. gibt, da dies die Ergebnisse verfälschen kann.

In Falle einer Sensibilisierung oder Reizung der Haut am Anwendungsort, sollten Sie die Verwendung einstellen und sich an Ihren Arzt wenden.

BENUTZUNGSHINWEISE

1) Leitungswasser den Test verfälschen – waschen Sie sich die Hände und trocknen Sie sie ab.



2) Entnehmen Sie die AMNIOCHECK-Slip inlage aus der Verpackung. Die Slip inlage enthält einen blassgelben Indikator.

3) Befestigen Sie die Slip inlage in Ihrer Unterhose. Der blassgelbe Indikatorstreifen sollte direkt an Ihrer Vagina sitzen. Tragen Sie die Slip inlage wie eine normale Slip inlage, bis Sie Nässe fühlen (nicht mehr als 12 Stunden). **Hinweis:** Verwenden Sie die Slip inlage im Sitzen, Stehen oder Gehen. Verwenden Sie die Slip inlage nicht im Liegen.

4) Wenn Sie auslaufende Flüssigkeit spüren, entnehmen Sie die Slip inlage und warten Sie 15 Minuten. Dann überprüfen Sie die Slip inlage auf eine Farbveränderung auf dem gelben Hintergrund. Achten Sie auch beim Auswechseln eines neuen Slip Einsatzes auf eine Farbänderung.

5) Wenn Sie Nässe fühlen und die Slip inlage nach mehreren 15 Minuten vollständig gelb ist, sollten Sie evtl. einen neuen Test machen.

6) Entsorgen Sie die Slip inlage wie andere Hygieneprodukte.

ERGEBNISAUSWERTUNG

15 MINUTEN NACH DEM ABZIEHEN, SUCHEN SIE NACH EINER FARBÄNDERUNG AUF DEM SLIP IN LAGE.

Die Ergebnismessung sollte an einem gut beleuchteten Ort durchgeführt werden.



WAHRSCHEINLICH AUSLAUFENDES FRUCHTWASSER

Wenn es eine Farbänderung zu blau oder grün gibt, sei es teilweise oder vollständig (jede Intensität), und in jeder Größe, Form oder Lage, auf der Slip inlage, ist die auslaufende Flüssigkeit wahrscheinlich Fruchtwasser. Die Farbänderung kann trüb aussehen und kann entlang eines Teils der gelben Streifenkante intensiver sein. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder gehen Sie unverzüglich ins Krankenhaus.

Wichtig: Der Indikatorstreifen kann auch blau oder grün werden, wenn eine vaginale Infektion festgestellt wird. Wenn die Anzeigetafel blau oder grün wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.



POSITIVES ERGEBNIS
Mögliche Farbnuancen des Flecks



NEGATIVES ERGEBNIS
Mögliche Farbnuancen des Flecks

WAHRSCHEINLICH NEGATIVES ERGEBNIS

Wenn die Slip inlage nicht die Farbe geändert hat (gelb blieb oder nach 15 Minuten gelb wurde), wurde die Vaginalnässe vermutlich nicht durch Fruchtwasser verursacht. Wenn Sie weiterhin vaginale Nässe spüren, verwenden Sie eine neue Slip inlage und wiederholen Sie den Test und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Warnung: Bei schweren Undichtigkeiten oder dem Verdacht auf kaputtes Wasser suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf, auch wenn das Gerät keine Farbänderung aufweist.

LEISTUNGSDATEN

Insgesamt 232 schwangere Frauen waren an einer Zulassungsstudie des AMNIOCHECK Test Kit beteiligt. Der AMNIOCHECK beweist als kontinuierlicher Test eine Empfindlichkeit von 97,06 % (99/102) mit einem 95-prozentigen Konfidenzintervall von [91,64 %; 99,39 %] und eine Spezifität von 96,92 % (126/130) mit einem 95-prozentigen Konfidenzintervall von [92,31 %; 99,16 %].

- 1) Bornstein J, Geva A, Salt I, Fait V, Schoenfeld A, Shoham HK, Sobel J. Nonintrusive diagnosis of premature ruptured amniotic membranes using a novel polymer. Am J Perinatol. 2006 Aug; 23(6):351-4.
- 2) Bornstein J, Ohel G, Sorokin Y, Reape KZ, Shnaider O, Kessary-Shoham H, Ophir E. Effectiveness of a novel home-based testing device for the detection of rupture of membranes. Am J Perinatol. 2009 Jan;26(1):45-50.

CONTENU

LE TEST AMNIOCHECK CONTIENT:

- 5 serviettes hygiéniques et des instructions d'utilisation (ref. 100088-5)
ou
- 30 serviettes hygiéniques et des instructions d'utilisation (Ref. 100088-30)



Conservez le test AMNIOCHECK fermé et utilisez-le immédiatement après ouverture.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pour garantir des résultats valides, n'utilisez pas l'appareil AMNIOCHECK si la réponse à l'une des questions suivantes est OUI :

- 1) Moins de 12 heures se sont écoulées après les rapports sexuels ?
- 2) Moins de 12 heures se sont écoulées après la douche vaginale ?


Pendant le saignement, la lecture des résultats peut nécessiter une assistance professionnelle. Indiquez toutes les situations de saignement à votre médecin.

Ignorez les résultats positifs et vérifiez s'il existe une possibilité d'humidité ou une humidité après la douche, le bain etc., car cela peut fausser les résultats.

En cas de sensibilisation ou d'irritation de la peau sur le site d'application, arrêtez l'utilisation et contactez votre médecin.

MODE D'EMPLOI

1) L'eau du robinet peut fausser le test - lavez et séchez vos mains.

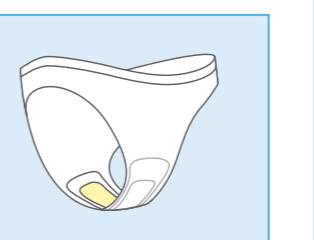

2) Déroulez la serviette hygiénique AMNIOCHECK. La serviette hygiénique contient un indicateur jaune pâle.

3) Collez la serviette hygiénique à vos sous-vêtements. La bande indicatrice jaune pâle devrait être placée directement contre votre vagin. Portez la serviette hygiénique comme une serviette hygiénique normale jusqu'à ce que vous ressentiez l'humidité (ne dépassez pas 12 heures). **Remarque :** utilisez la serviette hygiénique en position assise, debout ou en marchant. N'utilisez pas la serviette hygiénique en position couchée.

4) Lorsque vous ressentez une fuite de liquide, retirez la serviette hygiénique et attendez 15 minutes. Ensuite, vérifiez une modification de couleur sur le fond jaune de la serviette hygiénique. Même lorsque vous remplacez la serviette hygiénique, vérifiez un éventuel changement de couleur.

5) Si vous sentez de l'humidité et que la serviette hygiénique est complètement jaune au bout de quelques 15 minutes, envisagez d'utiliser un autre test.

6) Jetez la serviette hygiénique comme un autre produit d'hygiène.

LECTURE DE VOS RESULTATS

15 MINUTES APRÈS LE RETRAIT, RECHERCHEZ UN CHANGEMENT DE COULEUR SUR LA SERVETTE HYGIÉNIQUE.

La lecture des résultats doit se faire dans un endroit bien éclairé.



PROBABLE FUITE DE LIQUIDE AMNIOTIQUE

S'il y a un changement de couleur, partiel ou complet, au niveau du bleu ou du vert (de quelque intensité que ce soit), quelle qu'en soit la taille, la forme ou l'emplacement, sur la serviette hygiénique, la fuite de liquide est probablement une fuite de liquide amniotique. Le changement de couleur peut être nuageux et peut être plus intense sur une partie du bord de la bande jaune. Dans un tel cas, consultez votre médecin ou allez à l'hôpital sans délai.

Important : la bande indicatrice peut également devenir bleue ou verte si une infection vaginale est détectée. Si la bande indicatrice devient bleue ou verte, consultez toujours votre médecin.



RÉSULTAT POSITIF
possibles nuances de la couleur de la tache



RÉSULTAT NÉGATIF
possibles nuances de la couleur de la tache

PROBABLE RÉSULTAT NÉGATIF

Si la doubleur n'a pas changé de couleur (est restée jaune ou devient jaune au bout de 15 minutes), l'humidité vaginale n'était probablement pas causée par du liquide amniotique. Si vous continuez à ressentir de l'humidité vaginale, appliquez une nouvelle serviette hygiénique et répétez le test et consultez votre médecin.

Avertissement : En cas de fuites importantes ou de suspicion de perdre les eaux, veuillez consulter immédiatement un médecin, même si le dispositif ne change pas de couleur.

DONNEES DE PERFORMANCES

Un total de 232 femmes enceintes ont participé à l'étude pivot du Kit de test AMNIOCHECK. Le test de continuité AMNIOCHECK, a démontré une sensibilité de 97,06 % (99/102), avec un taux de 95 % d'IC [91,64 % ; 99,39 %] et une spécificité de 96,92 % (126/130), avec un taux de 95 % d'IC [92,31 % ; 99,16 %].

- 1) Bornstein J, Geva A, Salt I, Fait V, Schoenfeld A, Shoham HK, Sobel J. Nonintrusive diagnosis of premature ruptured amniotic membranes using a novel polymer. Am J Perinatol. 2006 Aug; 23(6):351-4.
- 2) Bornstein J, Ohel G, Sorokin Y, Reape KZ, Shnaider O, Kessary-Shoham H, Ophir E. Effectiveness of a novel home-based testing device for the detection of rupture of membranes. Am J Perinatol. 2009 Jan;26(1):45-50.

CONTENUTO

IL KIT DI AMNIOCHECK CONTIENE:

- 5 assorbenti-test 1 istruzione per l'uso (ref. 100088-5)
o
- 30